
Cama Classic XL

Ficha de consulta rápida

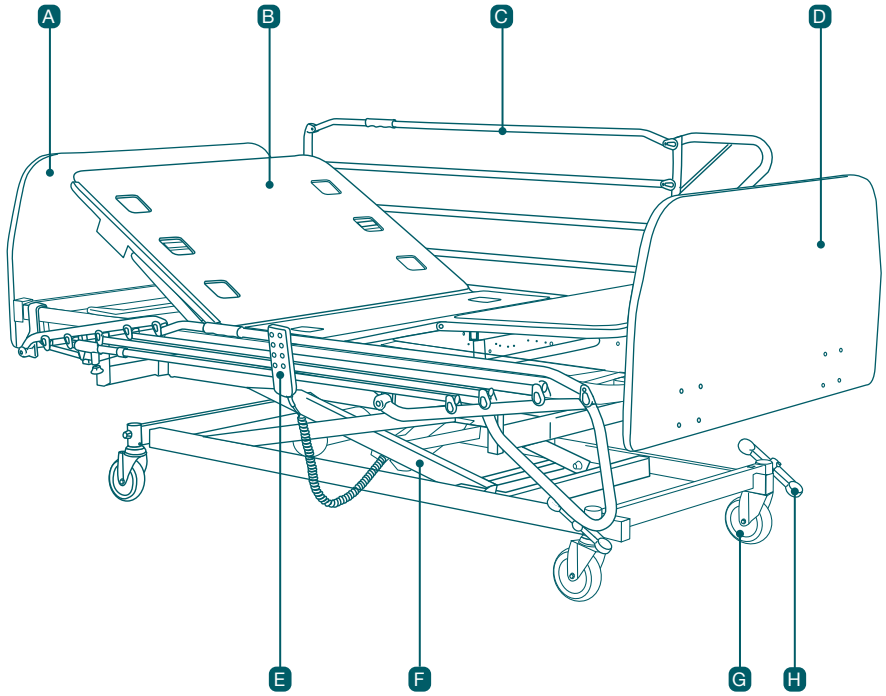

Componentes de la cama

A	Cabecero	E	Mando por cable
B	Lecho HPL	F	Carro elevador
C	Barandillas de tubos	G	Ruedas de chapa Ø12,5 cm.
D	Piecero	H	Pedal de freno centralizado


feb 2026 | Cód:PCO738268_FichaRapida_ClassicXL_ES_rev01


www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033


Barandillas


Barandillas de tubos:

- **Elevar barandillas:** Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama (1) hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior (2). La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- **Descender barandillas:** Desbloquear la maneta inferior de la barandilla (3) tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama (4) hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

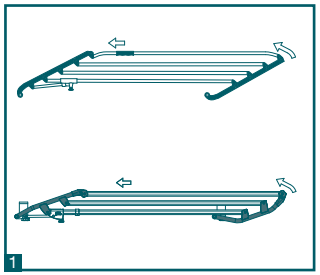

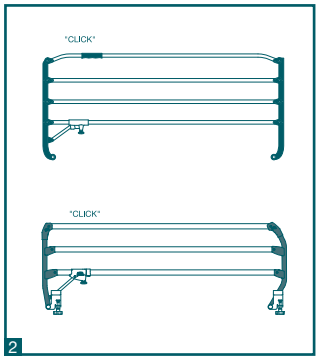

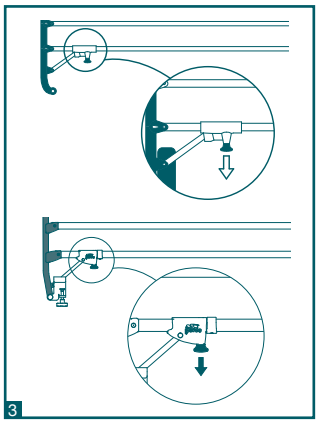

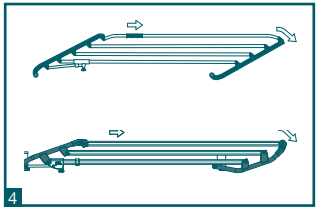

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Barandillas, cabecero, piecero, lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Otras funciones

Pedales de freno:


- Frenado de la cama: Pisar la palanca hasta llevarla a su posición más baja (1).

Desplazamiento de la cama:


- Subir con el pie la palanca hasta su posición intermedia (2).

Accionamiento de la rueda direcional:


- Para accionar eleve el pedal con el pie hasta la posición más alta (3).

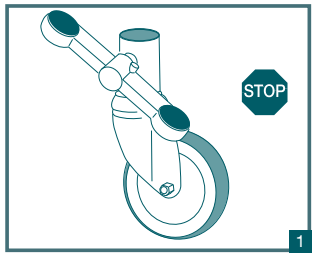

Freno

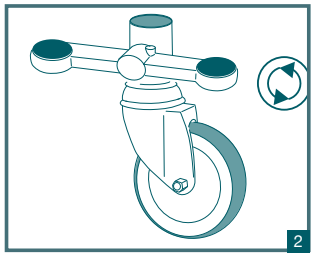


Movimiento libre

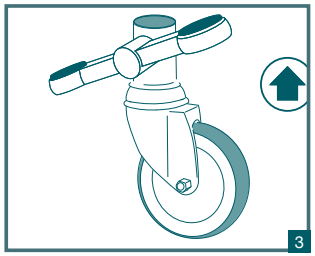

Rueda direccional

Mandos

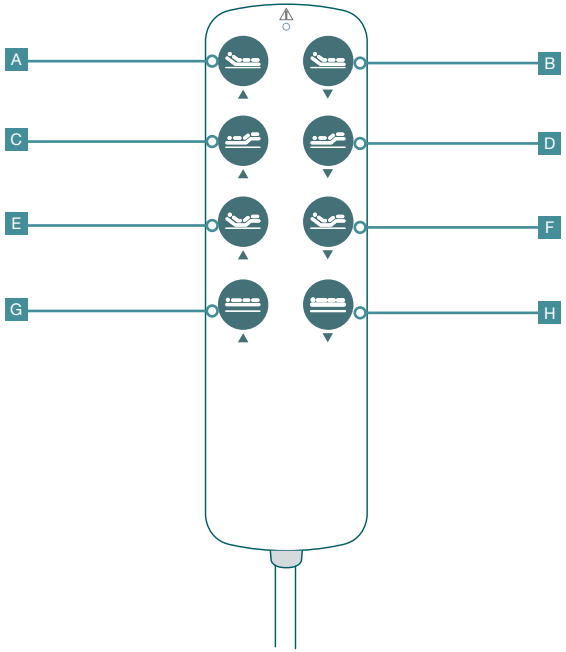

Mando por cable

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	E	Subir respaldo y extremidades simultánemente (autocontour)
B	Bajar respaldo	F	Bajar respaldo y extremidades simultáneamente (autocontour)
C	Subir extremidades	G	Elevar cama
D	Bajar extremidades	H	Descender cama

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.